



【通水】

中空糸膜は濃縮槽に充填され、ポンプによる吸引ろ過を行います。ろ過水は船外へ排出されます。スクラバ洗浄水は濃縮槽内で1/20まで濃縮され、スラッジタンクへ引き抜かれます。

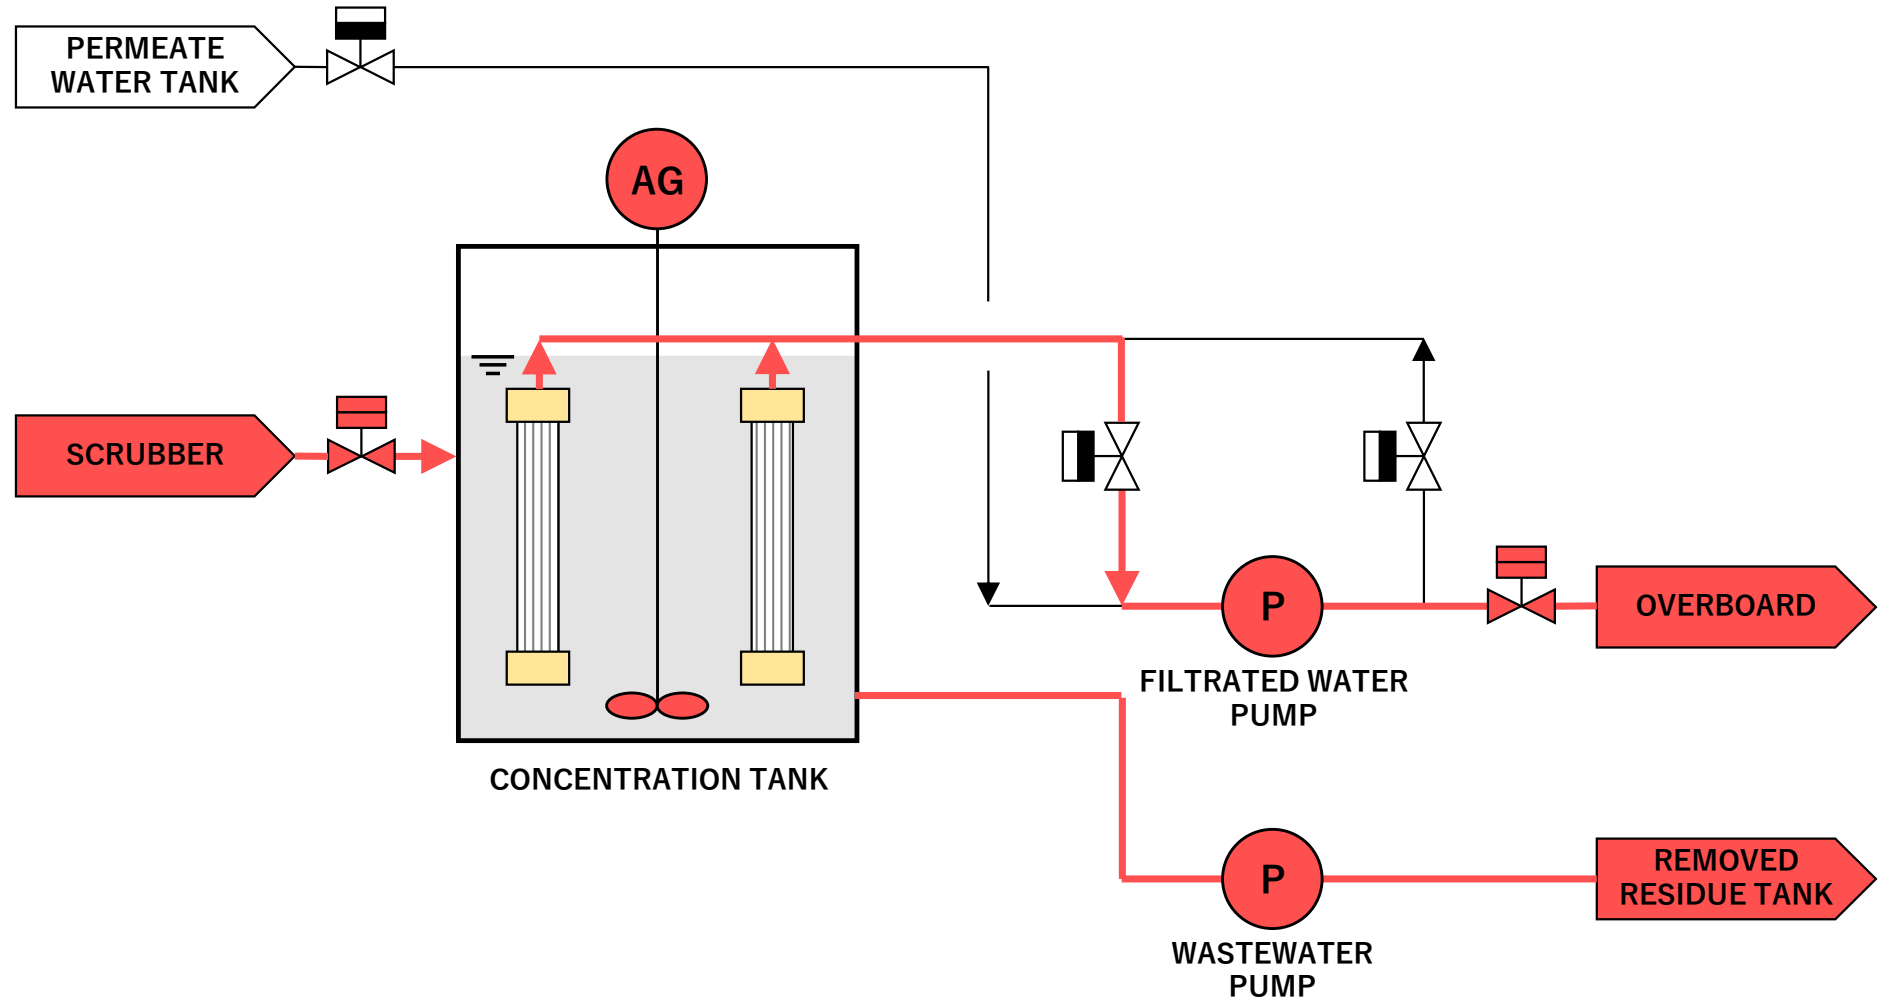

【逆洗】

膜の逆洗はろ過水により自動で行われます。

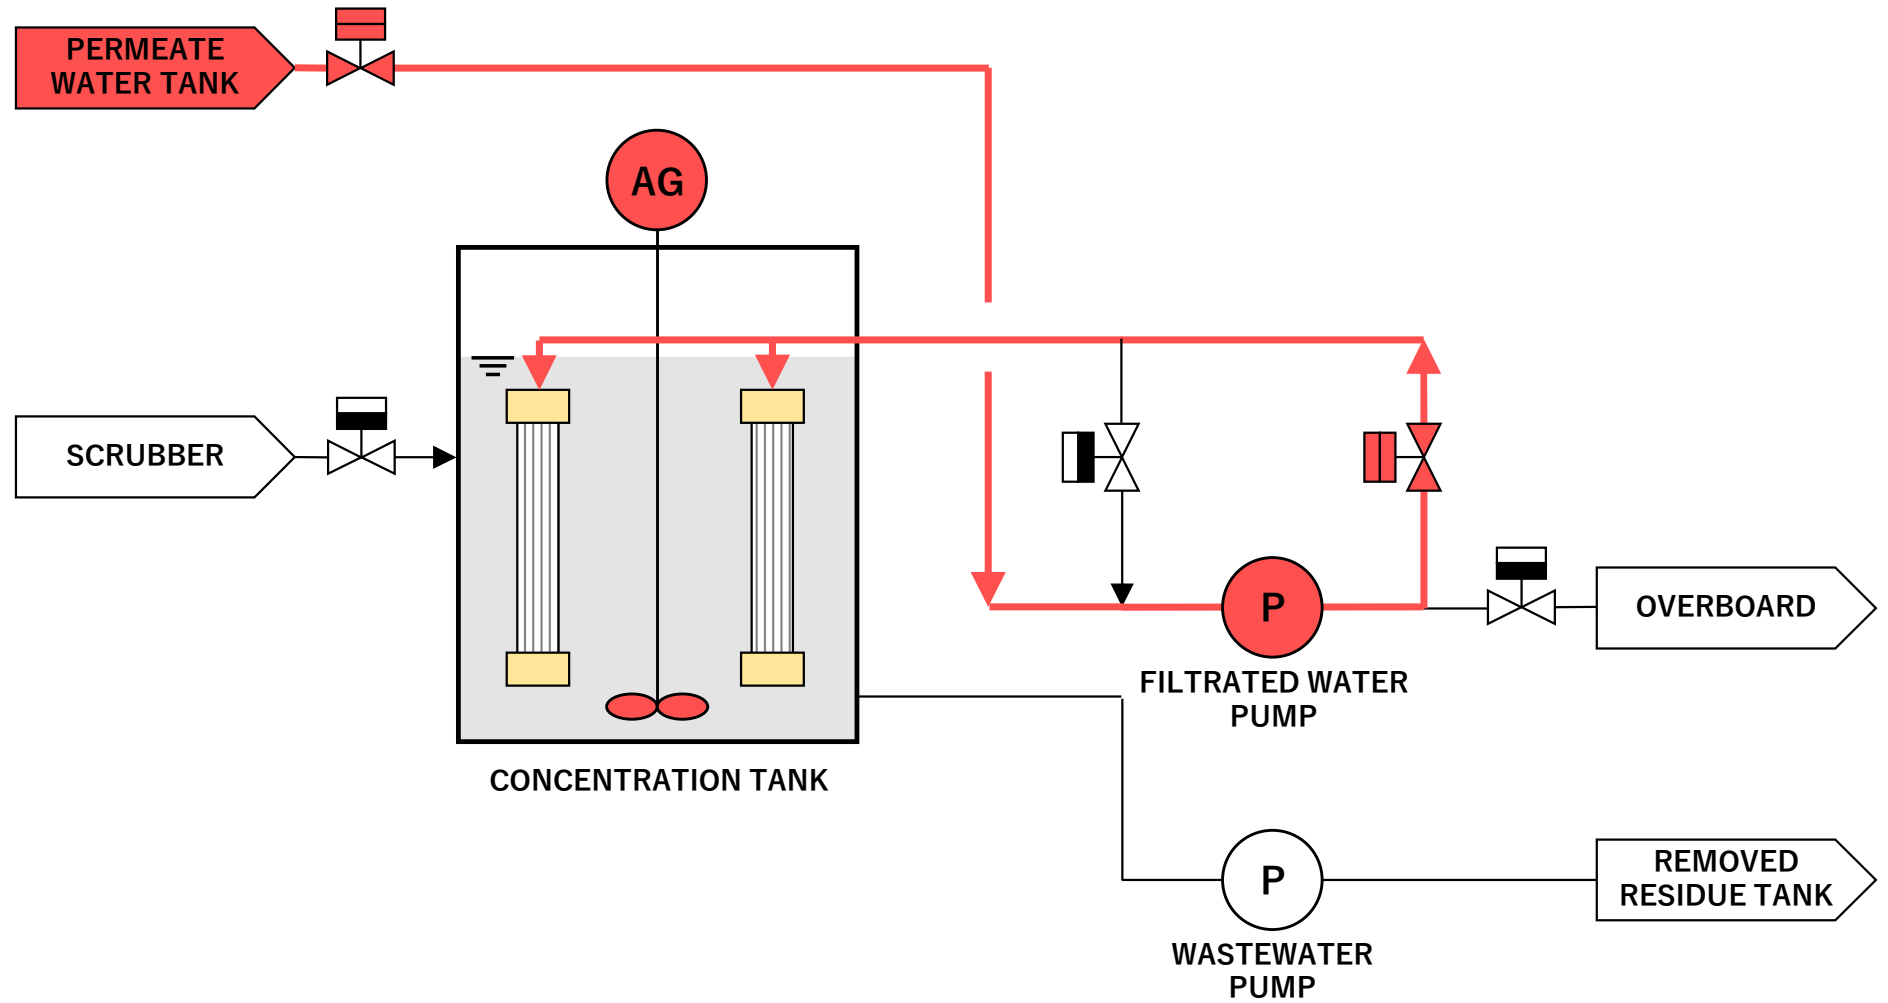

【薬品洗浄】

差圧が上昇してきた場合は薬品による浸漬洗浄を行います。

